

# IMMULITE



IMMULITE®

**Menu IMMULITE**  
 (import, export,  
 status okno,  
 prezeranie dat,  
 návrat)

Správa vyšetrení (zablokovanie metódik)

Import z CP

Export z CP

Datové okno

Návrat


Zaevidovanie  
 žiadanky

Stavový riadok

Naplň

Vynuluj

Stavové okno

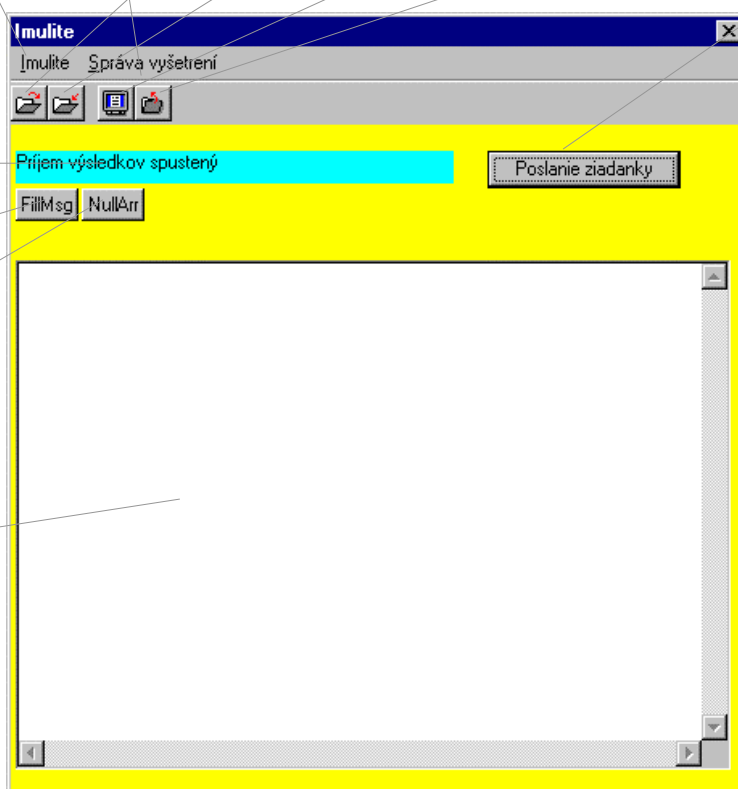

## DATOVÉ OKNO IMMULITE

návrat    Chod' na začiatok O jeden vpred    O jeden vzad    Chod' na koniec    Pridaj záznam    Vymaž záznam

ID dňa  
 Druh vzorky  
 Naliehavosť  
 Počet mat.  
 Počet výkonov  
 Opakovanie  
 Čiarový kód  
 Typ testu  
 Kód stroja  
 Stav testu  
 Popis vyšetrenia  
 Výsledok text  
 Stav

**Imulite - Data**

Subor    Editácia    Správca

Meno:  Rod Cislo:   
 Id Den:  Druh Vzorky:   
 Poc Mat:  Naliehavosť:   
 Opakovanie:  Poc Vyk:   
 Barcode Id:   
 Test Type:  Stav:   
 Kod Stroj:   
 Kod Popis:   
 Vysl Char:   
 Status:

Dt Prijem:	Id Den:	Vysl Char:	Barcode Id:
19971029	135		135
19971029	144		144
19971029	163		163
19971029	87		87
19971029	87		87
19971029	91		91
19971029	91		91
19971029	96	545445645	96
19971029	96		96
19971029	134		134
19971029	135	54	135
19971029	135	4	135
19971029	135	1	135
19971029	144	1	144
19971029	163	1	163
19971029	163		163

Zlá vzorka/dôvod    Dátum prijmu    ID dňa    Výsledok    Čiarový kód

## Tlač pracovného listu IMMULITE

**DataDialog Caption**

Prac list pre

Jednotlivé metodiky

Pacientov a vzorky

Metodiky

AFP  
CA125  
CA15-3  
CA19-9  
CEA  
Digoxin  
Estradiol

Vzorky

Od vzorky 1 09.12.1997

Do vzorky 1000 09.12.1997

Nastavenie tlačče Tlač Návrat